



2025年3月号 1/12

ジッパー 「エンジン リーマ」
VDW ZIPPERER 「ジッパー 手用ファイル」
 「U-ファイル」
 「ジッパー 手用クレンザー」
 「エンドマティック ヘッドストローム ファイル」

一部完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名: エンジン リーマ
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器承認番号: 21900BZX00449000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
13214	28mm 070	6	[完売] 代替品: 25mm 070	04562190631663

代替サイズ

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
13114	25mm 070	6		04562190631465

完売

- 販売名:ジッパー 手用ファイル
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000296

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
14005	NiTi Kファイル 21mm 035	6	[完売] 代替品: Kファイル 21mm 035	04562190632059
14103	NiTi Kファイル 25mm 025	6	[完売] 代替品: Kファイル 25mm 025	04562190632141
14006	NiTi Kファイル 21mm 040	6	[完売] 代替品: ジッパー 手用ファイル 滅菌済 Kファイル 21mm 040	04562190632066

代替品

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
11110	Kファイル 21mm 035	6		04562190636101
11208	Kファイル 25mm 025	6		04562190636309

- 販売名:ジッパー 手用ファイル 滅菌済
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000302

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
11111	Kファイル 21mm 040	6		04562190636118



完売


- 販売名:U-ファイル
- クラス分類:管理(Ⅱ) ●医療機器承認番号:21900BZX00450000

商品コード*	規格	内容包装	備考	GS1コード*
14605	30	6	[完売] 代替品:非切削性 強カスケラー エディ 28mm	04562190631151

代替品



超音波式ではなく 攪拌パワーに優れた
エアスケラー直結 音波式です。

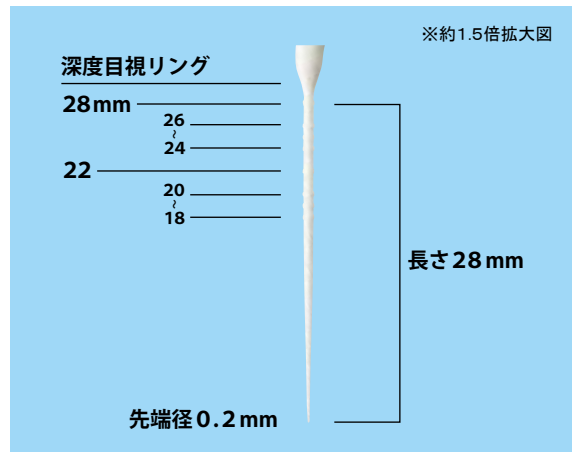

チェア直結! 対応 エアスケラー
使用周波数: 5000~6000Hz

- エアソルフィー (モリタ社)
- ルーティアー (サリーは非適合) (ヨシダ社)
- SONICflex 2000,2003 (2008は非適合) (カボ社)
- Ti-Max S970 (VA970は非適合) (ナカニシ社)
- シロエアール (シロナ社)



吉岡 俊彦Dr.

- 販売名:エア・ソニック 根管洗浄チップ 滅菌済
- クラス分類:一般(Ⅰ) ●医療機器届出番号:28B1X00005000344

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
18199	非切削性 強カスケラー エディ 28mm	10	滅菌済2本×5パック	04562190663282




完売

ハンドルつき

- 販売名:ジッパー 手用クレンザー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000081

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
14743	xxf (2)	10	[完売] 代替品:ジッパー クレンザー xxf (2)	04562190661080
14748	xxxxf (0)	150	[完売] 代替品:ジッパー クレンザー xxxxf (0)	04562190638709
14753	m (5)	150	[完売] 代替品:ジッパー クレンザー m (5)	04562190638754
14754	c (6)	150	[完売] 代替品:ジッパー クレンザー c (6)	04562190638761

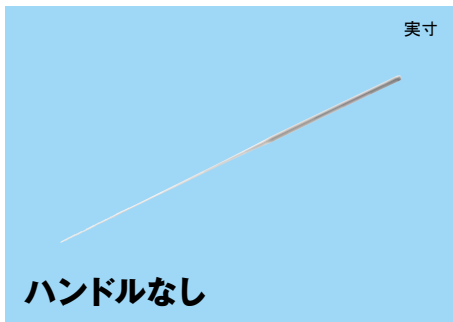

代替品

ハンドルなし

- 販売名:ジッパー クレンザー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000080

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
14723	xxf (2)	60		04562190661011
14731	xxxxf (0)	150		04562190638600
14736	m (5)	150		04562190638655
14737	c (6)	150		04562190638662

完売

- 販売名: エンドマテック ヘッドストローム ファイル
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器承認番号: 21900BZX00451000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
14901	21mm 010	6	[完売] 代替品: 25mm 010	04562190631915
14923	25mm 020	6	[完売] 代替品: 21mm 020	04562190631786

代替サイズ

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
14921	25mm 010	6		04562190631762
14903	21mm 020	6		04562190631717

ジッペラー
↓
オロチ

「ジッペラー カーバイド バー」
「ジッペラー スチール バー」

一部完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ジッペラー カーバイド バー・スチール バー全規格ともに在庫限り品として、完売次第オロチ カーバイドバー・スチールバーの同規格へと切り替えて参ります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

完売

- 販売名:ジッペラー カーバイド バー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000089

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17025	FG 170L	6	[完売] 代替品:オロチカーバイドバー FG 170L 1piece 1体型 歯質用	04580195086257
17026	FG 171L	6	[完売] 代替品:オロチカーバイドバー FG 171L 1piece 1体型 歯質用	04580195086264

代替品

- 販売名:オロチカーバイドバー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000343

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73052	FG 170L 1piece 1体型 歯質用	10		04571197457473
73053	FG 171L 1piece 1体型 歯質用	10		04571197457480

完売

- 販売名:ジッパー スチール バー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000085

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17605	HP 3	6	[完売] 代替品:オロチスチールバー HP 3	04580195087148
17606	HP 4	6	[完売] 代替品:オロチスチールバー HP 4	04580195087155

代替品

- 販売名:オロチスチールバー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000349

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73504	HP 3	6		04571197459200
73505	HP 4	6		04571197459217

完売

- 販売名:ジッパー スチール バー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000085

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17617	HP 36	6		04580195087261
17621	HP 40	6		04580195087308
17623	HP 557	6		04580195087322

代替品はございません。

茂久田商会 「5-D Japan エンドサージェリーキット」

MOKUDA

セット 完売 / 単品販売継続品のご案内


長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

セット完売

●販売名:5-D Japan エンドサージェリーキット

●クラス分類:一般(I)

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
64058	エンドサージェリーキット	1セット		04571197435655

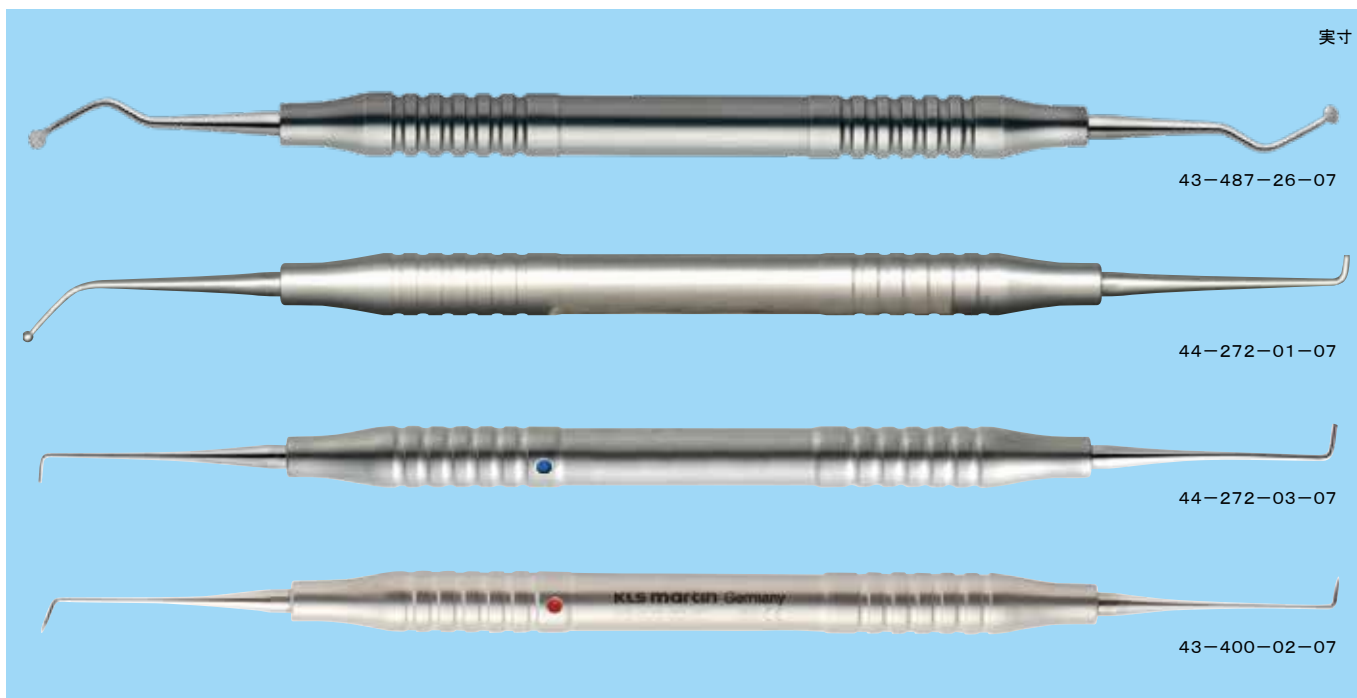

単品販売継続品

●販売名:マーチンエクスカベーター (マーチン社)

●クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000204

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
61242	43-487-26-07	1	Fig. GM18 全長: 17.5cm	04571197432425

●販売名:マーチン充填器 (マーチン社)

●クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000211

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
61489	44-272-01-07	1	5-Dジャパン全長: 16.5cm	04571197435365
61356	44-272-03-07	1	チューリッヒ 根切用 シングル全長: 17.5cm	04571197433569


- 販売名:マーチンエクスプローラー (マーチン社)
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000187

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
61187	43-400-02-07	1	チューリッヒ 全長: 17.5cm	04571197431879



- 販売名:低反射 ブラック 逆根管用 プラガー (コーラー社)
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000360

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
82005	50° φ0.5mm	1	PEEK ハンドルブラック DLC コーティング	04560195464163

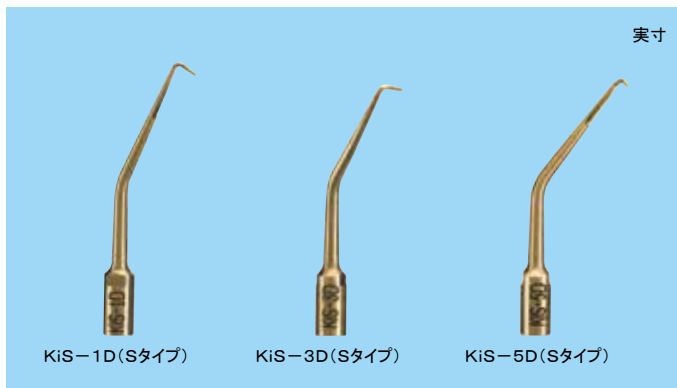

- 販売名:オブチュラ 超音波チップ (オブチュラ社)
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000293

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
65008	KiS-1D (タイプ)	1	ダイヤモンド ステンレス サテレック用	04580195088596
65010	KiS-3D (タイプ)	1	ダイヤモンド ステンレス サテレック用	04580195088619
65012	KiS-5D (タイプ)	1	ダイヤモンド ステンレス サテレック用	04580195088633

デンツプライ
DENTSPLY

「バイオブレンドIPN硬質レジン歯」

一部完売のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名: バイオブレンドIPN硬質レジン歯
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器認証番号: 222AGBZX00035000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
21603	U 116-32G	片顎6		04987741192156

代替品はございません。

<p>S.S.ホワイト</p> <p>↓</p> <p>オロチ</p>	<p>「ホワイト カーバイドバー」</p> <p style="background-color: #d9ead3; padding: 5px; border-radius: 15px; display: inline-block;">一部完売 / 代替品のご案内</p>
---	--

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ホワイト カーバイドバー全規格とも在庫限り品として、完売次第折れにくくてよく切れる オロチ カーバイドバーの同規格へと切り替えて参ります。

また、バー以外のWAX・ペーパーディスクは販売を継続しております。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

完売

- 販売名: ホワイト カーバイドバー
- クラス分類: 一般(I) ●医療機器届出番号: 28B1X00005000133

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
31066	FG 1171	10	[完売] 代替品: オロチ カーバイドバー FG 1171 1piece 1体型 歯質用	04580195074094

代替品

- 販売名: オロチ カーバイドバー
- クラス分類: 一般(I) ●医療機器届出番号: 28B1X00005000343

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73063	FG 1171 1piece 1体型 歯質用	10	マイクロモーター専用	04571197457589

ロエコ
roeko

「ステリ・スリーブ」

長さ変更のご案内

日本専用 特別ロングサイズ の製造が完了いたしましたので、ご案内を申し上げます。

長さ変更前の製品が完売次第、切り替えさせていただきます。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

長さ変更前

- 販売名:ステリ・スリーブ
- クラス分類:雑貨

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
35050		25	7.5× <u>112cm</u> 長	04580195082228

長さ変更後 (備考欄のみ表記変更)

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
35050		25	7.5× <u>100cm</u> 長	04580195082228